


測定結果

受付番号 : 2026
 サンプル名 : ユキザサ
 重量 : 0.870 (Kg)
 測定日 : 2012/04/23 15:19:47
 測定時間 : 910 (秒)

測定結果

測定機器: Berthold Technologies 社製 LB2045

核種名	エネルギー (KeV)	測定値 (CPS)	測定値±誤差 (Bq)	測定値±誤差 (Bq/Kg)	検出限界 (Bq/Kg)
ヨウ素-131	364	N. D.	N. D.	N. D.	2.00
セシウム-134	796.802	N. D.	N. D.	N. D.	1.95
セシウム-137	662	0.00	N. D.	N. D.	2.14
カリウム-40	1461	0.04	32.96±26.09	37.89±29.99	27.05

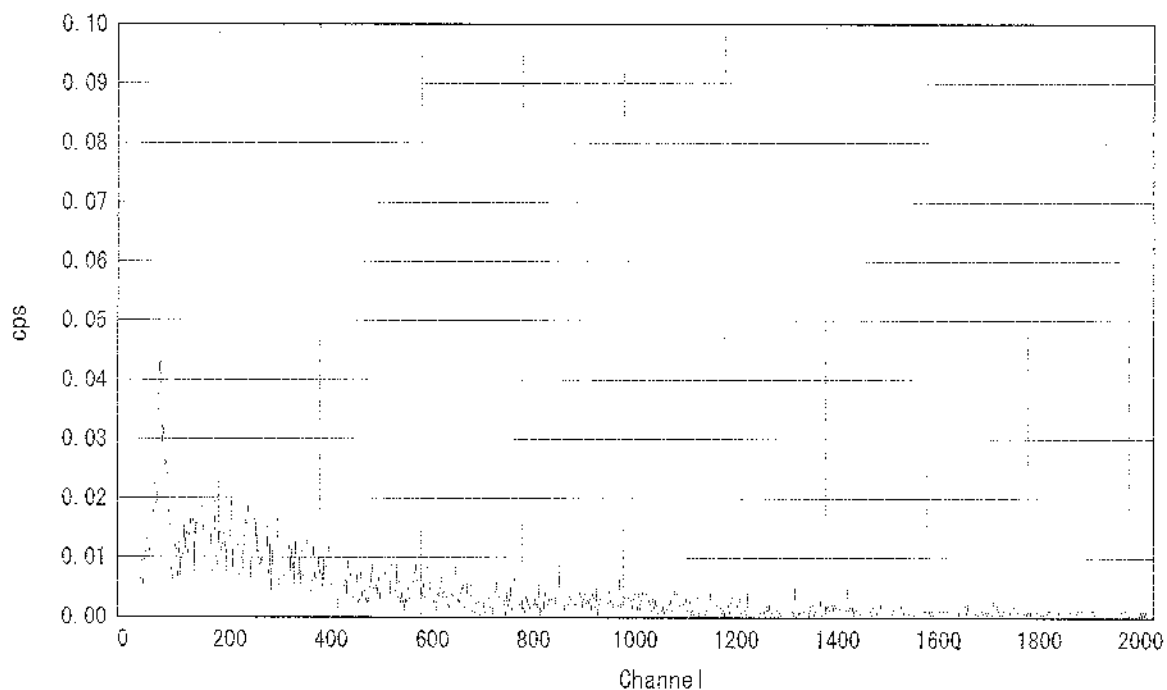

担当者	責任者